

Til dörförki třetí stomijní. Produkt zalecaný w przypadku ujevn hud rundt stoma eller en stoma plassert i en hudfod. Wystoszony przepis ochrony okostomijnej, herbowej skory engangsprodukter kan skade sikkemten og ytelsen. Avslutt brukn hvis infektionen oppstår.

I tilfelle en alvorlig episode må det søkes medisinsk råd for producenten, Welland Medical Ltd., og den lokale vedkommende myndighets kontaktes via distributør eller importør.

Si se produce un problema grave, busque asistencia médica antes de ponerse en contacto con el fabricante, Welland Medical Ltd., y la autoridad local competente a través de su distribuidor o importador.

Stomas ismäti suninkin. Rekomenduojama naujoli esant' parastominiemi švarzoms, nelygai peristominiel oda arba stomai, parastominiemi švarzoms, nelygai peristominiel oda arba stomai, esant' oda arba peristominiel oda arba stomai.

Uwaga: Używaj tylko na nieuszkodzonej skórze. Ponowne wykorzystanie jątkowisków urzucających jednorazowego wyrobu może spowodować poważne infekcje. W przypadku wystąpienia infekcji, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, a następnie producentem, firmą Welland Medical Ltd., i właściwym organem lokalnym za pośrednictwem dystrybutora lub importera.

Stomos išmäti suninkin. Rekomenduojama naujoli esant' parastominiemi švarzoms, nelygai peristominiel oda arba stomai, esant' oda arba peristominiel oda arba stomai.

Attention: A n'utiliser que sur une peau intacte. Ne réutiliser pas d'un dispositif mon usage pour empêcher la stoma et les instruments de prévention de l'infection. Interrrompre l'usage en présence d'infection.

In cas d'inconveniente grave, consulter un medico prima di contattare il produttore, Welland Medical Ltd. e la autorità locale competente tramite il proprio distributore o importatore.

Si se produce un problema grave, busque asistencia médica antes de ponerse en contacto con el fabricante, Welland Medical Ltd., y la autoridad local competente a través de su distribuidor o importador.

Stomos išmäti suninkin. Rekomenduojama naujoli esant' parastominiemi švarzoms, nelygai peristominiel oda arba stomai, esant' oda arba peristominiel oda arba stomai.

Attention: A n'utiliser que sur une peau intacte. Ne réutiliser pas d'un dispositif conçu pour empêcher la stoma et ses performances. Cesser d'utiliser le dispositif en cas d'infection.

En cas d'inconveniente sérieux, demander un avis médical avant de contacter le fabricant, Welland Medical Ltd., et votre autorité ou compétente locale par l'intermédiaire de votre distributeur ou importateur.

Si se produce un problema grave, busque asistencia médica antes de ponerse en contacto con el fabricante, Welland Medical Ltd., y la autoridad local competente a través de su distribuidor o importador.

Stomická pomůcka jednoduchá, Návod na použití.

Stomie do gniazda aparatów głosowych. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Stomie do gniazda aparatów głosowych. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Stomie do gniazda aparatów głosowych. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Stomie do gniazda aparatów głosowych. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Stomie do gniazda aparatów głosowych. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Stomie do gniazda aparatów głosowych. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Stomie do gniazda aparatów głosowych. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Stomie do gniazda aparatów głosowych. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Stomie do gniazda aparatów głosowych. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Stomie do gniazda aparatów głosowych. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Stomie do gniazda aparatów głosowych. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Stomie do gniazda aparatów głosowych. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Stomie do gniazda aparatów głosowych. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Stomie do gniazda aparatów głosowych. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Stomie do gniazda aparatów głosowych. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Za zberjanje izloženega organa v obveznosti uporabe. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Za zberjanje izloženega organa v obveznosti uporabe. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Za zberjanje izloženega organa v obveznosti uporabe. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Za zberjanje izloženega organa v obveznosti uporabe. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Za zberjanje izloženega organa v obveznosti uporabe. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Za zberjanje izloženega organa v obveznosti uporabe. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Za zberjanje izloženega organa v obveznosti uporabe. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Za zberjanje izloženega organa v obveznosti uporabe. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Za zberjanje izloženega organa v obveznosti uporabe. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Za zberjanje izloženega organa v obveznosti uporabe. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Za zberjanje izloženega organa v obveznosti uporabe. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Za zberjanje izloženega organa v obveznosti uporabe. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Za zberjanje izloženega organa v obveznosti uporabe. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Za zberjanje izloženega organa v obveznosti uporabe. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Za zberjanje izloženega organa v obveznosti uporabe. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma. Recomendado para os pacientes com hérnia de estôma.

Para recolher os efluentes do estoma. Recomendado para hérnias abdominais, para peristomias irregulares ou estomas posicionados numa pele comum.

Para utilizar a única fóscina para compõr a siguração. Si o dispositivo de unicó fóscina não pode garantir a performance. Utilizar rebuie de interrupção em caso de perigo.

Em caso de incidente grave, solicitar assistência médica imediata de um competente fabricante, Welland Medical Ltd., e autoridade competente local para o seu fornecedor ou importador.

No caso de um incidente grave, procurar aconselhamento médico antes de contactar o fabricante, a Welland Medical Ltd., e a autoridade competente local através do seu fornecedor ou importador.

Para recolher os efluentes do estoma. Recomendado para hérnias abdominais, para peristomias irregulares ou estomas posicionados numa pele comum.

Para utilizar a única fóscina para compõr a siguração. Si o dispositivo de unicó fóscina não pode garantir a performance. Utilizar rebuie de interrupção em caso de perigo.

Em caso de incidente grave, solicitar assistência médica imediata de um competente fabricante, Welland Medical Ltd., e autoridade competente local para o seu fornecedor ou importador.

Para recolher os efluentes do estoma. Recomendado para hérnias abdominais, para peristomias irregulares ou estomas posicionados numa pele comum.

Para utilizar a única fóscina para compõr a siguração. Si o dispositivo de unicó fóscina não pode garantir a performance. Utilizar rebuie de interrupção em caso de perigo.

Em caso de incidente grave, solicitar assistência médica imediata de um competente fabricante, Welland Medical Ltd., e autoridade competente local para o seu fornecedor ou importador.

Para recolher os efluentes do estoma. Recomendado para hérnias abdominais, para peristomias irregulares ou estomas posicionados numa pele comum.

Para utilizar a única fóscina para compõr a siguração. Si o dispositivo de unicó fóscina não pode garantir a performance. Utilizar rebuie de interrupção em caso de perigo.

Em caso de incidente grave, solicitar assistência médica imediata de um competente fabricante, Welland Medical Ltd., e autoridade competente local para o seu fornecedor ou importador.

Para recolher os efluentes do estoma. Recomendado para hérnias abdominais, para peristomias irregulares ou estomas posicionados numa pele comum.

Para utilizar a única fóscina para compõr a siguração. Si o dispositivo de unicó fóscina não pode garantir a performance. Utilizar rebuie de interrupção em caso de perigo.

Em caso de incidente grave, solicitar assistência médica imediata de um competente fabricante, Welland Medical Ltd., e autoridade competente local para o seu fornecedor ou importador.

Para recolher os efluentes do estoma. Recomendado para hérnias abdominais, para peristomias irregulares ou estomas posicionados numa pele comum.

Para utilizar a única fóscina para compõr a siguração. Si o dispositivo de unicó fóscina não pode garantir a performance. Utilizar rebuie de interrupção em caso de perigo.

Em caso de incidente grave, solicitar assistência médica imediata de um competente fabricante, Welland Medical Ltd., e autoridade competente local para o seu fornecedor ou importador.

Para recolher os efluentes do estoma. Recomendado para hérnias abdominais, para peristomias irregulares ou estomas posicionados numa pele comum.

Para utilizar a única fóscina para compõr a siguração. Si o dispositivo de unicó fóscina não pode garantir a performance. Utilizar rebuie de interrupção em caso de perigo.

Em caso de incidente grave, solicitar assistência médica imediata de um competente fabricante, Welland Medical Ltd., e autoridade competente local para o seu fornecedor ou importador.

Para recolher os efluentes do estoma. Recomendado para hérnias abdominais, para peristomias irregulares ou estomas posicionados numa pele comum.

Para utilizar a única fóscina para compõr a siguração. Si o dispositivo de unicó fóscina não pode garantir a performance. Utilizar rebuie de interrupção em caso de perigo.

Em caso de incidente grave, solicitar assistência médica imediata de um competente fabricante, Welland Medical Ltd., e autoridade competente local para o seu fornecedor ou importador.

Para recolher os efluentes do estoma. Recomendado para hérnias abdominais, para peristomias irregulares ou estomas posicionados numa pele comum.

Para utilizar a única fóscina para compõr a siguração. Si o dispositivo de unicó fóscina não pode garantir a performance. Utilizar rebuie de interrupção em caso de perigo.

Em caso de incidente grave, solicitar assistência médica imediata de um competente fabricante, Welland Medical Ltd., e autoridade competente local para o seu fornecedor ou importador.

Para recolher os efluentes do estoma. Recomendado para hérnias abdominais, para peristomias irregulares ou estomas posicionados numa pele comum.

Para utilizar a única fóscina para compõr a siguração. Si o dispositivo de unicó fóscina não pode garantir a performance. Utilizar rebuie de interrupção em caso de perigo.

Em caso de incidente grave, solicitar assistência médica imediata de um competente fabricante, Welland Medical Ltd., e autoridade competente local para o seu fornecedor ou importador.

Para recolher os efluentes do estoma. Recomendado para hérnias abdominais, para peristomias irregulares ou estomas posicionados numa pele comum.

Para utilizar a única fóscina para compõr a siguração. Si o dispositivo de unicó fóscina não pode garantir a performance. Utilizar rebuie de interrupção em caso de perigo.

Em caso de incidente grave, solicitar assistência médica imediata de um competente fabricante, Welland Medical Ltd., e autoridade competente local para o seu fornecedor ou importador.

Para recolher os efluentes do estoma. Recomendado para hérnias abdominais, para peristomias irregulares ou estomas posicionados numa pele comum.

Para utilizar a única fóscina para compõr a siguração. Si o dispositivo de unicó fóscina não pode garantir a performance. Utilizar rebuie de interrupção em caso de perigo.


Em caso de incidente grave, solicitar assistência médica imediata de um competente fabricante, Welland Medical Ltd., e autoridade competente local para o seu fornecedor ou importador.

Para recolher os efluentes do estoma. Recomendado para hérnias abdominais, para peristomias irregulares ou estomas posicionados numa pele comum.




Para utilizar a única fóscina para compõr a siguração. Si o dispositivo de unicó fóscina não pode garantir a performance. Utilizar rebuie de interrupção em caso de perigo.

Em caso de incidente grave, solicitar assistência médica imediata de um competente fabricante, Welland Medical Ltd., e autoridade competente local para o seu fornecedor ou importador.




1

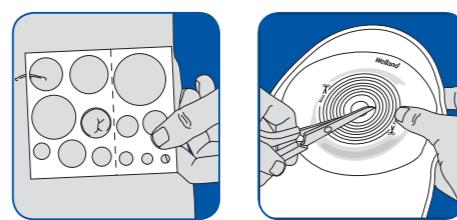


2

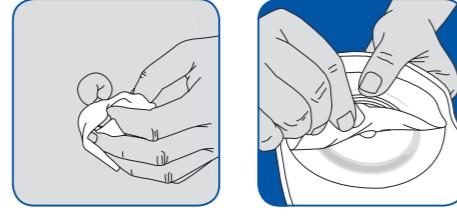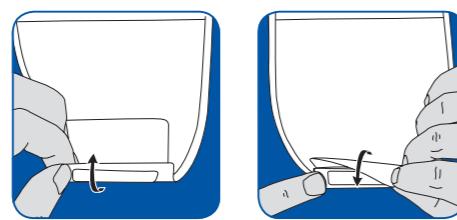


+
XBLT067 XBLT167
XBLT073 XBLT173
XBLT077 XBLT177
XBLT082 XBLT182
XBLT092 XBLT192
XBLT098 XBLT198

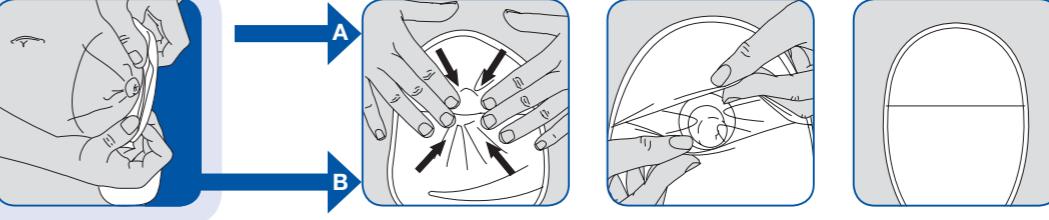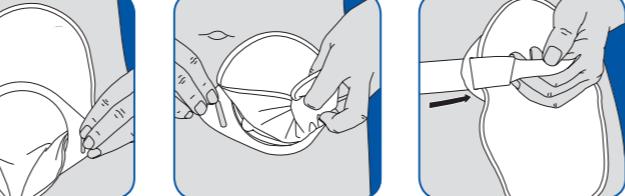

3



4

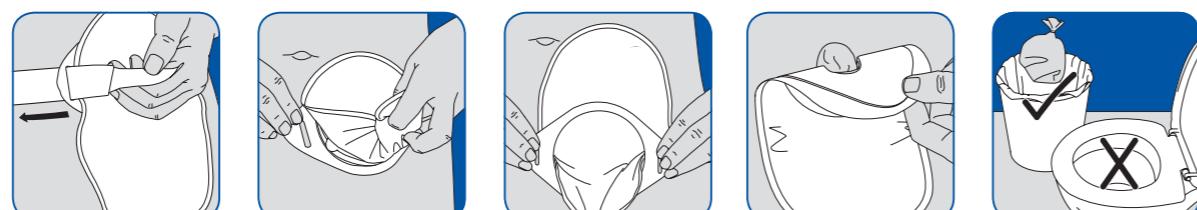

Welland
Medical